



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 870 02 80
Fax. : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : **CLINIQUE NEST (SENEGAL)**
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE
N° 22-210-T66-05

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : Enregistreur de température
(Designation)

Constructeur : FISHTEC
(Manufacturer)

Identification : TH-T2221-06
(Identification)

Modèle /N° Série : T2221 /
(Model)/ (Serial N°)

Localisation : LABO
(Location)

Date d'étalonnage : 17 / 11 / 2022
(Calibration date)

Lieu d'étalonnage : LAME (DAKAR-SENEGAL)
(Calibration spot)

Etalonnage réalisé par : BADO BOYE/MARAME FALL
(Operator)

Résultats d'étalonnage : Page(s) suivante(s)
Calibration results Next page

Observations (Remarks): /

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SMILÉ PHOTOGRAPHIQUE
INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend: 2 page(s)
(this document includes)

Date d'émission: 29 NOVEMBRE 2022
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager



M. Lamine Bara DIAGNE

ETALONNAGE ENREGISTREUR DE TEMPERATURE (CALIBRATION TEMPERATURE RECORDER)

1. **Date d'étalonnage** (date of calibration) : **17/11/2022**
2. **Opérateur** (Operator) : **BADO BOYE/MARAME FALL**
3. **IDENTIFICATION DES ETALONS OU REFERENCES UTILISES :**
(Identification of support equipment used for assessment)

N° ID (ID N°)	TYPE (Model)	CONSTRUCTEUR (Manufacturer)	N° CERTIFICAT (N° Certificate)	CONFORMITE jus qu'au: (Cal due)
TI 01+TE-01	PT100	AGILENT	P221113/ 1	JUIN 2023

4. MODE OPERATOIRE


L'étalonnage est effectué par comparaison entre les valeurs lues sur la référence en température du LAME et celles lues sur l'instrument à étalonner (client).

The calibration is realized by direct comparison of the master calibration equipment values with the customer instrument.

5. RESULTATS

Température

Temps (min)	Etalon T1 (°C)	Instrument à étalonner T2 (°C)	Ecart T2-T1 (°C)	Observation
0	27,0	27,1	0,1	
10	27,0	27,1	0,1	
20	27,0	27,1	0,1	
30	27,0	27,1	0,1	
40	27,0	27,1	0,1	
50	27,0	27,1	0,1	
60	27,0	27,1	0,1	
70	27,0	27,1	0,1	
80	27,0	27,1	0,1	
90	27,0	27,1	0,1	
100	27,0	27,1	0,1	
Minimum	27,0	27,1	0,1	
Maximum	27,0	27,1	0,1	
Moyenne	27,0	27,1	0,1	

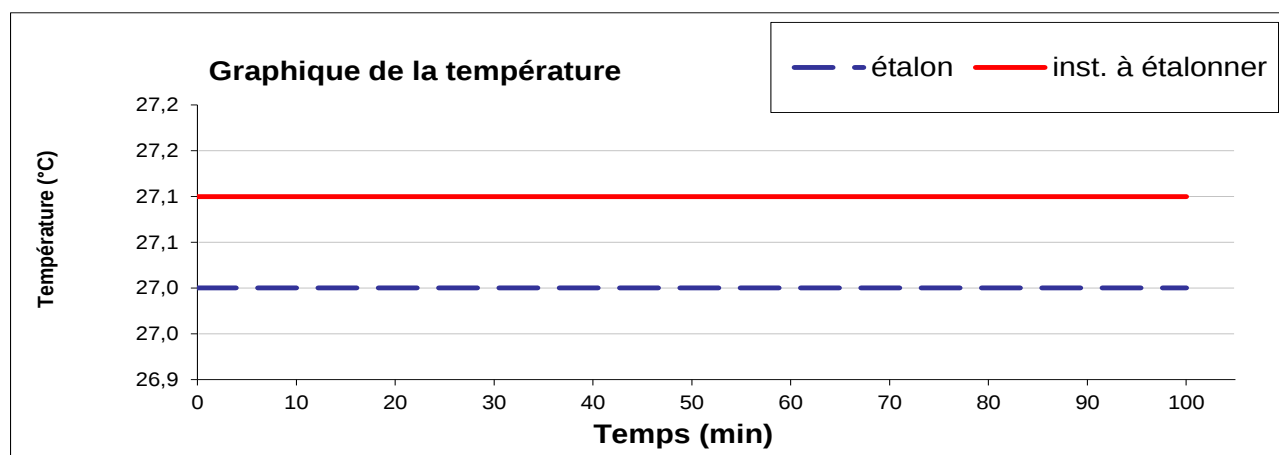

Observations :

Les moyennes des températures lues sur la chaîne de mesure étalon ainsi que les corrections apportées ont été arrondies en tenant compte de la résolution de l'indicateur.

Fin du certificat d'étalonnage