



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 870 02 80
Fax. : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CHECK

N° 210/S22264-08

INSTRUMENT ETALONNE CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : **BALANCE (PESE ADULTE)**
(Designation)

Constructeur : **/**
(Manufacturer)

Portée maximale : **150 kg**
(Max range)

Echelon de vérification : **1 kg**
(Echelon)

Identification : **P-MD-MES-004**
(Identification)

Modèle /N° Série : **/**
(Model)/ (Serial N°)

Portée Minimale : **/**
(Min range)

Echelon réel : **1 kg**
(Resolution)

Date d'étalonnage : **21 / 09 / 2022**
(Calibration date)

Lieu d'étalonnage : **CLINIQUE NEST (DAKAR-SENEGAL)**
(Calibration spot)

Etalonnage réalisé par : **BADO BOYE**
(Operator)

Résultats d'étalonnage : **Page(s) suivante(s)**
Calibration results Next page


Observations (Remarks): **/**

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILÉ INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend : **2 page(s)**
(this document includes)

Date d'émission: **27 Septembre 2022**
(Date of issue)

Le Responsable du Laboratoire
The Laboratory Manager

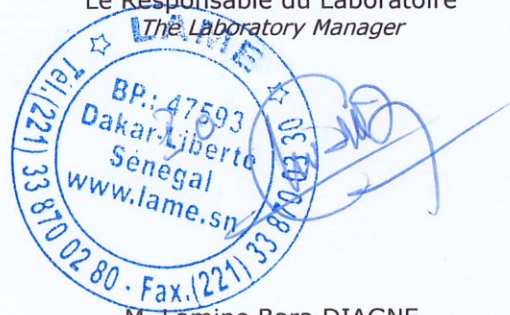

M. Lamine Bara DIAGNE

Vérification périodique technique

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Désignation : **BALANCE (PESE ADULTE)**

Marque : /

Porté Max : 150 kg

Echelon : 1 kg

Modèle : /

Classe : IIII

Porté Min : /

Résolution : 1 kg

N° de série : /

Localisation : **Salle des Constantes**

Identification : **P-MD-MES-004**

ESSAIS AVANT CALIBRAGE :

Valeur lue avant calibrage			
Charge		Valeur lue	
20	kg	19	kg

ESSAIS PREALABLES : Conforme

Mise à niveau : Conforme

Essai de zéro : Conforme

Essai de tare : Conforme

ESSAI DE JUSTESSE : Conforme


Charges		Valeur lue		Erreur	
5	kg	4	kg	-1	kg
20	kg	19	kg	-1	kg
60	kg	58	kg	-2	kg
80	kg	78	kg	-2	kg
120	kg	118	kg	-2	kg
80	kg	78	kg	-2	kg
60	kg	58	kg	-2	kg
20	kg	19	kg	-1	kg
5	kg	4	kg	-1	kg

ESSAI DE FIDELITE : Conforme

Poids de contrôle: 60 kg (3 essais)			Ecart Max (kg)
58	57	58	1

ESSAI D'EXCENTRATION : Conforme

Masse de Contrôle : 20 kg



N°	Valeur lue		Ecart(kg)	
1	19	kg	-1	kg
2	19	kg	-1	kg
3	19	kg	-1	kg
4	19	kg	-1	kg
5	19	kg	-1	kg

N° CERTIFICAT DES POIDS UTILISES (RACCORDÉS AU SI)
 N° 22-000-M449 du 21/04/2022
 N° 22-000-M450 du 25/04/2022
 N° 22-000-M418 du 19/05/2021

DECISION FINALE :

Conforme

Date d'étalonnage : 21/09/2022

Opérateur : BADO BOYE

► Détermination de l'erreur maximale tolérée (EMT) de la balance suivant la charge :

Erreurs maximales tolérées en vérification périodique	Pour des charges m exprimées en échelons de vérification e			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII
$\pm 1 e$	$0 \leq m \leq 50\,000$	$0 \leq m \leq 5\,000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 2 e$	$50\,000 < m \leq 200\,000$	$5\,000 < m \leq 20\,000$	$500 < m \leq 2\,000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 3 e$	$200\,000 < m$	$20\,000 < m \leq 100\,000$	$2\,000 < m \leq 10\,000$	$200 < m \leq 1\,000$

- Pour une masse déposée entre 0 et 50 kg compris, la tolérance est de 1 kg.
- Pour une masse déposée entre 50 kg et plus, la tolérance est de 3 kg.

Fin du constat de vérification