



Route de Petit Mbao
BP 47593 Dakar Liberté
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 870 02 80
Fax. : (221) 33 870 03 30
E-mail: contact@lame.sn

Délivré à : CLINIQUE NEST (SENEGAL)
Issued for

64 liberté 6 Extension
VDN Nord, Dakar
☎ (221) 33 8675858 - (221) 765047342

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° 22-210-T755-05

INSTRUMENT ETALONNE

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : THERMO-HYGROMETRE
(Designation)

Constructeur : OEM
(Manufacturer)

Identification : TH-1909278322
(Identification)

Modèle /N° Série : HTC-1/ 1909278322
(Model)/ (Serial N°)

Localisation : /
(Location)

Date d'étalonnage : 21 / 09 / 2022
(Calibration date)

Lieu d'étalonnage : LAME (DAKAR-SENEGAL)
(Calibration spot)

Etalonnage réalisé par : BADO BOYE
(Operator)

Résultats d'étalonnage: Page(s) suivante(s)
Calibration results Next page

Observations (Remarks): /

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SMILÉ INTÉGRAL
THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE

Ce document comprend: 2 page(s)
(this document includes)

Date d'émission: 29 SEPTEMBRE 2022
(Date of issue)



M. Lamine Bara DIAGNE

ETALONNAGE D'UN THERMO-HYGROMETRE (THERMOMETER CALIBRATION)

1. **Date d'étalonnage** (date of calibration) : **21/09/2022**
2. **Opérateur** (Operator) : **BADO BOYE**
3. **Identification instrument étalonné** : **TH-1909278322**
4. **IDENTIFICATION DES ETALONS OU REFERENCES UTILISES** :
(Identification of support equipment used for assessment)

N° ID (ID N°)	TYPE (Model)	CONSTRUCTEUR (Manufacturer)	N° CERTIFICAT (N° Certificate)	CONFORMITE jus qu'au: (Cal due)
TE-18	TESTO 635-1	TESTO	426	20 NOVEMBRE 2022


5. MODE OPERATOIRE

L'étalonnage est effectué par comparaison entre les valeurs lues sur la référence en température du LAME et celles lues sur l'instrument à étalonner (client).

The calibration is realized by direct comparison of the master calibration equipment values with the customer instrument.

Température

Temps (min)	Etalon T1 (°C)	Instrument à étalonner T2 (°C)	Ecart T2-T1 (°C)
0	26,8	24,7	-2,1
5	26,7	24,6	-2,1
10	26,6	24,5	-2,1
15	26,5	24,4	-2,1
20	26,4	24,3	-2,1
25	26,4	24,3	-2,1
30	26,3	24,2	-2,1
35	26,3	24,2	-2,1
40	26,3	24,2	-2,1
45	26,3	24,2	-2,1
50	26,3	24,2	-2,1
Minimum	26,3	24,2	-2,1
Maximum	26,8	24,7	-2,1
Moyenne	26,4	24,3	-2,1

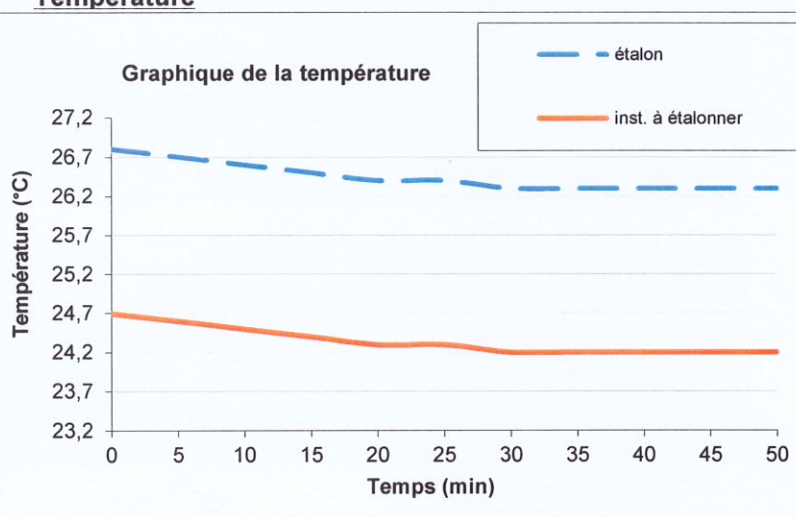


6.

RESULTATS

Humidité

Temps (mn)	Etalon H1 (%)	Instrument à étalonner H2 (%)	Ecart H2-H1 (%)
0	47	44	-3
5	47	43	-4
10	46	43	-3
15	46	43	-3
20	46	43	-3
25	46	43	-3
30	46	43	-3
35	46	43	-3
40	46	43	-3
45	46	43	-3
50	46	43	-3
Minimum	46,4	43	-3,5
Maximum	46,5	44	-2,5
Moyenne	46,4	43	-3,3

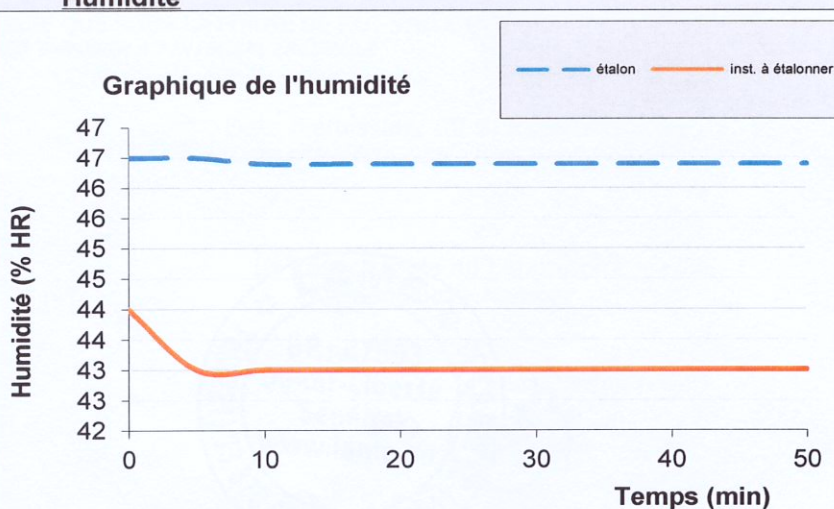

Fin du certificat d'étalonnage